

# アプリケータ仕様変更等のご案内

黄体ホルモン剤

薬価基準未収載

## ルティナス® 膣錠 100mg

Lutinus® Vaginal Tablet プロゲステロン膣錠 処方箋医薬品 注意-医師等の処方箋により使用すること



謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
 平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
 さてこのたび、「ルティナス®膣錠 100mg」の国内市場への安定供給を目的とし、専用アプリケータの製造所を現在のエスアールシー メディカル インク:SRC Medical, Inc. (USA)に加えて、ノラート メディテック アベ: Nolato MediTech AB. (Sweden)を新たに追加致します。  
 つきましては、ノラート メディテック アベにて製造される包装仕様等について、エスアールシー メディカル インクとの仕様相違点を下記にご案内申し上げます。  
 何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げますとともに、今度もより一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

### 記


<b>品 目</b>	ルティナス®膣錠 100mg
<b>仕様相違点</b>	<p>①ルティナス®膣錠 100mg専用アプリケータ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 錠剤装着部、押し出し棒の形状を変更します。</li> <li>▶ 個包装した21本のアプリケータをまとめてピロー包装し(ポリプロピレン製)、個装箱に封入します。</li> <li>▶ 個包装袋の素材をポリエチレンからポリプロピレンに変更します。</li> </ul> <p>※錠剤の装着機能、材質、大きさに相違はありませんが、仕様変更のため、「患者向けの仕様変更のお知らせ」文書を用意しています。                  ※ルティナス®膣錠自体の変更はございません。</p> <p>②個装箱</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 「Progesterone vaginal Tablet」の背景色をピンク色から無色に変更します。</li> </ul> <p>製品の国内安定供給の理由より、当面エスアールシー メディカル インク製、およびノラート メディテック アベ製のアプリケータが出荷されますことをご了承くださいますようお願い申し上げます。</p>

以上

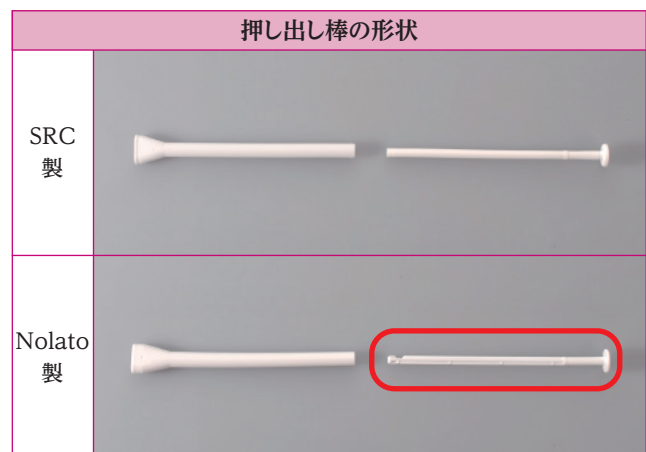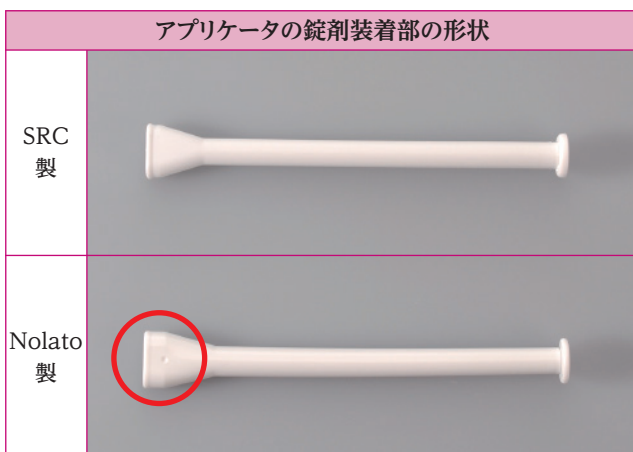

裏面もご確認ください。

外装・個装箱

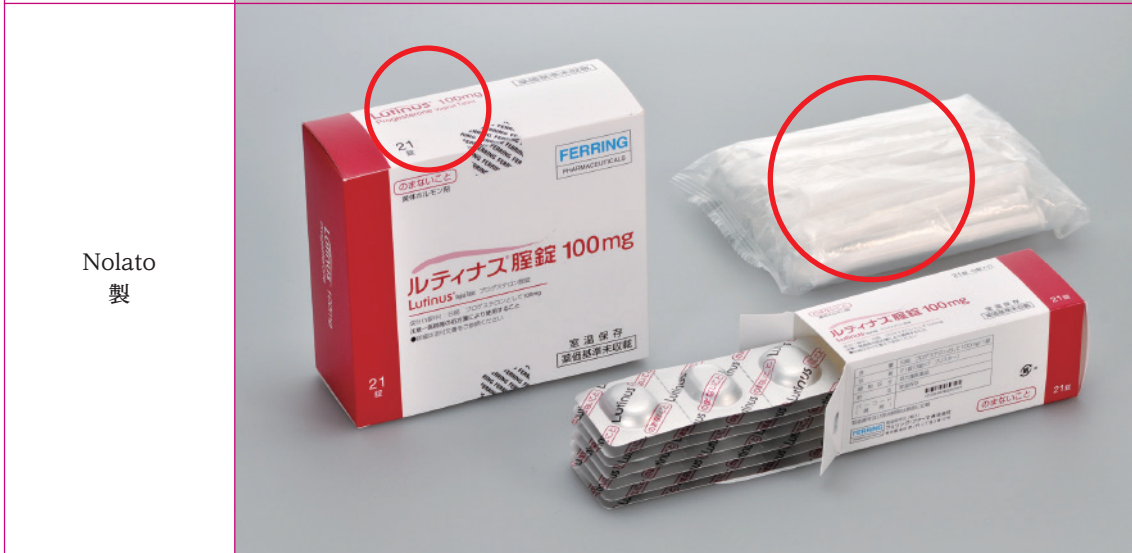

アプリケータ個包装袋の素材

SRC 製	ポリエチレン
Nolato 製	ポリプロピレン

変更品の識別方法

変更に伴う個装箱への表示は致しませんのでご了承ください。

変更品の出荷予定時期、製造番号、統一商品コード

出荷予定時期	2016年12月	製造番号	SI672A	統一商品コード	802-24711-5
--------	----------	------	--------	---------	-------------

\*在庫状況により変更品がお手元に届く時期が若干前後する場合がございますがご了承ください。